

Znak: DOAT 58/05/2016

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie znak: 03/03/2016

Pytanie nr 1

Pakiet nr 18 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie lepszej cenowo oferty.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Pakiet nr 22 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrod do EKG o średnicy 43 mm lub wymiarach 43mm/46mm. Dopuszczenie produktu o powyższych parametrach pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 3

Pakiet nr 23 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników na zużyty sprzęt o średnicy pojemnika: dolna 30 cm, górna 35 cm oraz wysokości 30 cm. Dopuszczenie produktu o powyższych parametrach pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4

Pakiet nr 26 poz. 3 – 6, 12 - 16

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie lepszej cenowo oferty.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5

Pakiet nr 36 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka do mycia głowy pacjenta, nie wymagającego dodatkowego namoczenia głowy, zawierającego w składzie: wodę, nie wymagającego spłukiwania, z szamponem i odżywką, bezzapachowy (nie zawiera perfum), średnica czepka 32 cm, do stosowania w temperaturze pokojowej lub do podgrzewania w mikrofalówce, przez 15-20 sekund (w opakowaniu) przy mocy 800 W. Nadaje się mycia włosów zanieczyszczonych min. krwią, żelazem EEG, zawierający w składzie Diazolidinyl Urea, hamujący rozwój grzybów, pleśni oraz flory.

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 6

Pakiet nr 5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 5 do osobnego pakietu i dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego pakiecie 5 w pozycji 1 zestawu tracheotomii przezskórnej zakładanego metodą Ciaglia Blue Ruino z zastosowaniem techniki Selinger? W skład zestawu wchodzi :

1. rozszerzyć w kształcie rogu nosorożca, pokryty w części dystalnej wzdłużnymi rowkami, na którym tworzy się warstwa hydrofilna po uprzednim zanurzeniu w wodzie: rozszerzacz posiada wzmocniony uchwyt
2. przewodniki rurki tracheotomijnej w rozmiarach: 21Fr, 24Fr, 27Fr
3. igła w rozmiarze 15G
4. igła z osłoną w rozmiarze 15G
5. rozszerzacz w rozmiarze 14Fr
6. skalpel
7. strzykawka
8. czerwony pojemnik na zużyte igły
9. żel poślizgowy i gąbki z gazy
10. rurka tracheotomijna typu Versatube w rozmiarze 7Fr lub 8Fr lub 9Fr.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Pakiet 30. Taśmy i siatki ginekologiczne.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 30 poz. 2 siatki dwuramienną o wymiarze: szer. 6,3 cm, wysokość 12 cm, z dodatkową górną wypustką o szer. 6,3 cm i wysokości 4 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 30, pozycja nr 1:

30 szt. taśm, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na ramionach, jednorodnych, niewchłaniających, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 μm , porowatości 84 %, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m^2 , wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ?

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 30, pozycja nr 2:

10 szt. siatek, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na ramionach, jednorodnych, niewchłaniających, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, najszerszy wymiar w środkowej części 3,5 cm, porowatości max 1870 μm , porowatości 84 %, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m^2 , wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ?

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 30, pozycja nr 2:

10 szt. siatek, jednorodnych, niewchłaniających, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m^2 , porowatość max 1870 μm , porowatość 84 %, długość ramion 45 cm, szerokość ramion 1,1 cm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wysokość implantu 12 cm, wypustka: wysokość 4 cm, szerokość 3,5 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ?

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 11

SIWZ – rozdz. XII – pełnomocnictwo

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Odpowiedz:

TAK

Pytanie nr 12

SIWZ – rozdz. XV

Prosimy o dopuszczenie aby termin dostaw był wyrażony w dniach roboczych od pon. do pt. (bez sobót, niedzieli i świąt)

Odpowiedz:

NIE

Pytanie nr 13

Projekt umowy – par. 2 ust. 3

W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni w kalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do par. 2 ust. 3 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy

Odpowiedz:

NIE

Pytanie nr 14

Projekt umowy – par. 2 ust. 6

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy – ust. 6 z par. 2. Proponowany zapis umowny stanowi obejście art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia,

stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związana, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

Odpowiedz:

NIE

Pytanie nr 15

Projekt umowy – par. 4 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o modyfikację §4 ust. 3 projektu umowy, i dopuszczenie zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymywaniu cen brutto na niezmiennym poziomie, spowoduje, że przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej.

Dodatkowo powszechnie przyjęta na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi o konstrukcyjnej zasadzie neutralności VAT dla podatnika- podatek ten powinien obciążyć nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę)- celem uniknięcia konieczności wprowadzenia zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawki VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Odpowiedz:

TAK

Pytanie nr 16

Projekt umowy – par. 6 ust. 7 lit. d)

Prosimy o odstąpienie o od wymogu zawartego w par. 6 ust. 7 lit. d) Projektu umowy. Zamieszczenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „siwz”), tworzonej w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, wymogu dostarczenia elektronicznej faktury w konkretnym formacie (tj. wygenerowanej przy użyciu wyraźnie wskazanego przez Zamawiającego oprogramowania określonego producenta) należy uznać za naruszenie fundamentalnych zasad udzielania zamówień ustanowionych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177, tekst jedn.) (dalej: „ppz”), tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz zasady uczciwej konkurencji.

Zasada równości nakłada na Zamawiającego obowiązek równego traktowania wszystkich Wykonawców, które powinno występować na każdym etapie postępowania, bez stosowania przywilejów, ale także środków dyskryminujących Wykonawców ze względu na ich właściwości. Równe traktowanie odnosi się zarówno do aspektu merytorycznego, jak i formalnego zamówienia. Może zatem dojść do naruszenia tej zasady przez celową eliminację Wykonawców i doprowadzenie do sytuacji, w której tylko jeden z nich weźmie udział w postępowaniu. Z kolei zasada uczciwej konkurencji nakłada na Zamawiającego obowiązek przygotowania i

prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. Naruszenie uczciwej konkurencji to nie tylko eliminowanie z ubiegania się o zamówienie niektórych Wykonawców przez wskazanie nazbyt konkretnego wymogu, ale także bezzasadne utrudnianie przygotowania, złożenia i realizacji oferty przez Wykonawców. Błędem Zamawiającego jest w szczególności wprowadzanie bez racjonalnego uzasadnienia do siwz wymogów, które nadmiernie różnicują pozycję Wykonawców w postępowaniu (patrz: wyrok KIO/UZP 1734/09 z 22 grudnia 2009 r. dot. absurdalnych wymogów stawianych przez Zamawiającego). Trzeba stwierdzić, że wskazanie w siwz wymogu dostarczenia faktury w wersji elektronicznej wygenerowanej przez konkretny program i oczekiwanie od Wykonawców dostarczania faktur w konkretnym formacie Datafarm, stanowi celowe utrudnienie dla Wykonawców i ograniczenie przez Zamawiającego dostępu do wzięcia udziału w postępowaniu. Wykonawcy mogą bowiem korzystać z oprogramowania różnych producentów, niekoniecznie z oprogramowania podanego przez Zamawiającego. Można tutaj mówić o zawołowanej formie ograniczenia konkurencji poprzez wprowadzenie ograniczenia nie bezpośrednio w przedmiocie zamówienia, ale warunkach formalnych wymaganych przy zamówieniu. Ponadto jest to ustalenie wymagań na tyle rygorystyczne i nieobiektywne, że nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego, ale ogranicza katalog Wykonawców będących w stanie wykonać zamówienie nawet do jednego Wykonawcy. Tymczasem wymogi zawarte w siwz powinny odzwierciedlać rzeczywiste i racjonalne potrzeby Zamawiającego w konkretnym postępowaniu oraz nie pozostawać w oderwaniu od warunków rynkowych. Każde uszczegółowienie zamówienia czy też wprowadzenie dodatkowego warunku udziału w postępowaniu może prowadzić do ograniczenia konkurencji.

W związku z powyższym zwracamy się o zaprzestanie naruszeń zasady równego traktowania Wykonawców oraz zasady uczciwej konkurencji, a tym samym opracowanie i zamieszczenie w siwz wymogów umożliwiających wszystkim Wykonawcom działania na równych warunkach. Należy bowiem zaznaczyć, że naruszenie zasad wymienionych w art. 7 pzp prowadzi do wadliwości postępowania o udzielenie zamówienia oraz powoduje powstanie prawa do wniesienia środków ochrony prawnej po stronie Wykonawców, którzy mogą powoływać się na złamanie zasad przez Zamawiającego zarówno w zapisach siwz, jak i podczas dokonywania badania i oceny ofert.

Odpowiedz:

Format danych „DATAFARM” nie wskazuje tylko i wyłącznie jednego dostawcę oprogramowania, jest to format, który funkcjonuje na rynku od dawna i z którego korzysta wiele firm i hurtowni np. farmaceutycznych. Obowiązek przekazywania faktur w wersji elektronicznej ma na celu przyśpieszenie pracy przy wprowadzaniu danych zakupionego asortymentu (data ważności, numery seryjne, itd.) do systemu komputerowego, jak również wyeliminowanie ewentualnych pomyłek mogących towarzyszyć w/w operacji. Zamawiający dopuszcza również inne formaty jak BLOZ, BAZYL, lub inny format tekstowy typu "csv", który będzie zawierał takie dane jak:

DATA WAŻNOŚCI, CENA NETTO, CENA BRUTTO, KOD PRODUKTU, VAT, ILOŚĆ OPAKOWAŃ,
SERIA

Pytanie nr 17

Projekt umowy – par. 6 ust. 7 lit. d)

Prosimy aby symbol REF/ numer katalogowy, seria i data ważności znajdowały się na dokumencie WZ załączonym do faktury.

Odpowiedz:

Dopuszcza ale nie wymaga pod warunkiem, że powyższe informacje będą uiszczone na fakturze

Pytanie nr 18

Projekt umowy – par. 7 ust. 2

Prosimy o dopuszczenie aby termin wymiany wadliwego towaru był wyrażony w dniach roboczych od pon. do pt. (bez sobót, niedziel i świąt)

Odpowiedz:

NIE

Pytanie nr 19

Projekt umowy – par. 8 ust. 4

Prosimy o zmianę ww. paragrafu umowy i dodanie zapisu, że „wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, chyba że zaległości te przekroczą 30 dni ponad termin wyrażony w par. 8 ust. 1.

Odpowiedz:

NIE

Pytanie nr 20

Projekt umowy – par. 9 ust. 3

Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości reklamowanego towaru.

Odpowiedz:

NIE

Pytanie nr 21

Projekt umowy – par. 9 ust. 4

Prosimy o odniesienie kary umownej wymienionej w par. 9 ust. 4 projektu umowy do 10% wartości umowy pozostałej do realizacji. Kara w obecnej wysokości jest w naszej ocenie za wysoka. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminową płatność zapłaci Wykonawcy jedynie odsetki w wysokości ustawowej. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) „Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedz:

NIE

Pytanie nr 22

Pakiet nr 21 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 152 x 90 mm x 150 kartek.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza i prosi o przeliczenie zgodnie z zamówieniem

Pytanie nr 23

Pakiet nr 21 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 107 mm x 23 m w op. – 1 szt.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 24

Pakiet nr 21 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 107 mm x 23 m.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 25

Pakiet nr 21 poz. 11

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować papier oryginalny czy Zamawiający dopuści również papier będący zamiennikiem papieru oryginalnego?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 26

Pakiet nr 22 poz. 1, 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary z sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania. Podanie cen za opakowania nie będzie przewyższało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałyby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 27

Część nr 22 poz. 1, 2

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na podanie cen jednostkowych za opakowanie, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedz:

-

Pytanie nr 28

Pakiet 29 poz. 1

Wykonawca uważa, że w punkcie 1 pakietu 29 została popełniona pomyłka w opisie „Elektroda nożowa o długości roboczej 1.9 i wtykiem 2,4 mm”. W związku z tym Wykonawca pyta czy Zamawiający wymaga zaoferowania elektrody nożowej o długości roboczej 19mm, z wtykiem o średnicy 2,4 mm ze stali nierdzewnej sterylnej, jednorazowego użytku?

Odpowiedz:

Nastąpiła pomyłka – powinno być 19 mm

Pytanie nr 29

Pakiet 31 poz. 2

Czy Zamawiający do puści zaoferowanie jednorazowej elektrody biernej do diatermii:

- dwudzielnej
- przystosowana do systemu REM
- pokrytej hydrożelem
- kształt prostokątny o wymiarach 20x12,2 cm
- szerokość podłączenia 4 x 2,5 cm
- etykiety do wklejenia do dokumentacji pacjenta

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 30

Pakiet 32 poz. 2

Czy Zamawiający do puści zaoferowanie jednorazowej elektrody biernej kompatybilnej z diatermią ERBE ICC 200:

- dwudzielnej
- z pierścieniem ekwipotencjonalnym
- o powierzchni 90cm²
- etykiety do wklejenia do dokumentacji pacjenta

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 31

Pakiet nr 2 pozycja 3

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane dreny lejek stożek oraz lejek-lejek w pozycji nr 3 były pakowane sterylne w podwójne opakowania folia-papier oraz były wyposażone w dodatkowe ochronne zatyczki chroniące światło drenu przed zabrudzeniem.

Odpowiedz:

WYMAGA

Pytanie nr 32

Pakiet nr 3 pozycja 2 i 6

Prosimy o potwierdzenie, czy w pozycji nr 2 i 6 należy zaoferować wkłady workowe kompatybilne z akcesoriami wielorazowego użytku (uchwyty, wózki, pojemniki) systemu serres?

Odpowiedz:

TAK

Pytanie nr 33

Pakiet nr 3 pozycja 2 i 6

Prosimy o potwierdzenie, czy w pozycji nr 2 i 6 należy zaoferować wkłady workowe posiadające w pokrywie tylko jeden króciec przyłączeniowy – kątowy, obrotowy typu schodkowego dopasowujący się różnych średnic drenów?

Odpowiedz:

TAK

Pytanie nr 34

Pakiet nr 4 w pozycji 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji 2 dopuści rurki intubacyjne noworodkowe w rozmiarze 2,0 zamiast rozmiaru 1,5 ze względu na brak występowania takiego rozmiaru rurek na rynku?

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 35

Pakiet nr 4 w pozycji 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycji 3 dopuści rurki tracheostomijne w rozmiarach: 6,0 zamiast rozmiaru 6,5; 7,0 zamiast rozmiaru 7,5; 8,0 zamiast rozmiaru 8,5; 10,0 zamiast rozmiaru 9,5; spełniające pozostałe wymagania określone w SIWZ?

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 36

Pakiet nr 20

Czy Zamawiający dopuści ofertę na ostrza bez grawera nazwy producenta? Brak wystarczającego miejsca na ostrzu uniemożliwia umieszczenia na nim grawera nazwy producenta. Zgoda na zaoferowanie ostrzy bez grawera pozwoli zamawiającemu na uzyskanie większej liczby ofert jak również wpłynie na zwiększenie konkurencji cenowej.

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 37

Pakiet nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drenu łączonego o następujących końcówkach: lejek – lejek, lub lejek – stożek z dodatkowym regulatorem siły ssania z zatyczką?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 38

Pakiet nr 17 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie silikonowych cewników Kehra?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 39

Pakiet nr 8 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści

Odpowiedz:

-

Pytanie nr 40

Pakiet nr 8 poz. 1

Czy zamawiający dopuści serwetę z włókniny SMS 35g o rozmiarze 50/60cm do zawinięcia zestawu?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 41

Pakiet nr 8 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestawy w opakowaniu foliowo – papierowym bez oznakowanego kierunku otwierania?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 42

Pakiet nr 8 poz. 2

Czy zamawiający dopuści serwetę z włókniny SMS 35g o rozmiarze 50/60cm?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 43

Pakiet nr 8 poz. 2

Czy zamawiający dopuści znaki CE oraz jednorazowego użycia po jednej stronie narzędzia?

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 44

Pakiet nr 8 poz. 2

Czy zamawiający dopuści zestawy w opakowaniu foliowo – papierowym bez oznakowanego kierunku otwierania?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 45

Pakiet nr 8 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 46

Pakiet nr 36 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierające w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Pakowane pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W). Zapachowy. Zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Odpowiedz:

NIE DOPUSZCZA

Pytanie nr 47

Pakiet nr 36 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jednorazowy, antybakteryjny czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierające w składzie m.in. chlorek cetylpirydyny oraz disodium EDTA. Pakowane pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W). Zapachowy. Zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 48

Pakiecie 38

W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych pasków testowych do glukometrów będących zastrzeżonymi znakami towarowymi konkretnego producenta, informujemy że paski danych marek są kompatybilne wyłącznie z glukometrami tych samych marek, co jednakże ograniczyłoby konkurencję do wyrobu konkretnego wytwórcy nadając mu praktyczną wyłączność na kształtowanie ceny oferty. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający postępując zgodnie z ustawą Pzp (art. 7 i 29 ustawy) i mając na uwadze potencjalne oszczędności wynikłe z dopuszczenia zaofiarowania produktu konkurencyjnego, wyrazi zgodę na zaofiarowanie wysokiej jakości konkurencyjnych pasków testowych (wraz z dostarczeniem kompatybilnych z nimi glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego) charakteryzujących się parametrami opisanymi poniżej:

Funkcja Auto-coding eliminująca kodowanie; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu; d) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s; f) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi włosniczkowej z opuszek palców, a także krwi żyłnej i tętnicznej; g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych; h) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy od otwarcia (opakowanie jednostkowe zawiera 2 fiołki x 25 pasków); i) zakres hematokrytu 20-60% i zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie;

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 49

Pakiet 7 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie czujnika o długości 0,9 m

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 50

Pakiet 12 poz. 5

Prosimy o wydzielenie pozycji 5 do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 51

Pakiet nr 10 poz. 16

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej większej liczbie wykonawców.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 52

Pakiet 18 poz. 1, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonana z FEP. PTFE tak jak i FEP są to polimery szeroko stosowane w medycynie. PTFE -teflon to nazwa handlowa zastrzeżona przez firmę DuPont. PTFE i FEP są teflonami o podobnym składzie chemicznym, bez zawartości lateksu informacja na opakowaniu. Dlatego, też prosimy o dopuszczenie proponowanych przez nas kaniul, które jakościowo nie odbiegają od proponowanych przez firmę Becton Dickinson a cenowo są konkurencyjne.

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 53

Pakiet nr 18 poz. 3-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji kaniuli bezpiecznej z korkiem portu bocznego samozamykającym się typu Klik plastikową osłoną zabezpieczającą przed zakłuciem z 4 widocznymi na całej długości kaniuli paskami rtg, z zastawką antyzwrotną. Proponowany przez Państwa zapis wskazuje tylko jednego producenta kaniul, co uniemożliwia złożenie ofert innym Wykonawcom.

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Zielony	18 G	1,2 x 45	90
		1,2x 32	90
Różowy	20 G	1,0 x 33	64
Niebieski	22 G	0,8 x 25	33

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 54

Pakiet nr 18 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji koreczka kompatybilnego z kaniulami dostępnymi na rynku.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 55

Pakiet 18 poz. 7

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji karnika z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty – zamknięty.

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 56

Pakiet nr 18 poz.13

Prosimy zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 57

Pakiet 8 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia z 1 szt. serwety foliowanej, rozm. 75 cm x 75 cm o gramaturze 42 g/m² (owinięcie) , przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 58

Pakiet 8 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wklucia centralnego z 1 szt. serwety foliowanej rozm. 75 x 45 cm o gramaturze 43 g/m² z przylepnym otworem 10 cm i 1 szt. kleszczyków metalowych z zaciskiem, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 59

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedz:

TAK jak KP

Pytanie nr 60

Zważywszy na treść § 2 ust. 1 i 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 61

Czy Zamawiający zgadza się aby § 4 ust. 3 wzoru umowy zdanie pierwsze otrzymało następującą (lub podobną) treść: „*W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.*”?

Zarówno przy podwyższeniu jak i przy obniżeniu stawki podatku VAT, zmiana stawki podatku VAT powinna skutkować zmianą wartości brutto, przy zachowaniu dotychczasowych cen i wartości netto. Aktualna treść w § 4 ust. 3 wzoru umowy utrudni wykonawcom należyte skalkulowanie ceny oferty; wymaga zatem modyfikacji.

Odpowiedz:

TAK

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 4 wzoru umowy w zdaniu pierwszym zostało dodane wyrażenie „, *chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni*”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 4 wzoru umowy zostało wykreślone zdanie drugie?

Wykonawca nie powinien być zmuszany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a w konsekwencji zagrozić zdolności wykonawcy do dalszego wykonywania zamówienia publicznego. Poza tym, skuteczność § 8 ust. 4 wzoru umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana np. na podstawie art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedz:

NIE

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby odstąpienie od umowy zostało poprzedzone wezwaniem do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedz:

NIE

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „*10% wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy*” zostało zastąpione wyrażeniem „*10% niezrealizowanej wartości umowy brutto*”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedz:

NIE

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 5 wzoru umowy otrzymał następującą (lub podobną) treść: „*Wykonawca może dochodzenie w postępowaniu procesowym zaległych należności wynikających z niniejszej Umowy poprzedzić postępowaniem pojednawczym wskazanym w art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego.*”?

Przymus stosowania sądowego postępowania pojednawczego jako sposobu rozstrzygnięcia wszelkich sporów nie jest celowy. Postępowanie pojednawcze wymaga bowiem dodatkowych kosztów. Poza tym na posiedzenie sądu w postępowaniu pojednawczym trzeba zwykle czekać co najmniej kilka miesięcy. Przede wszystkim jednak, jeżeli strony będą gotowe do podpisania ugody i osiągną porozumienie w tym zakresie, to mogą podpisać ugodę pozasądową bez wszczynania postępowania pojednawczego. Jeżeli natomiast strony nie osiągną porozumienia co do podpisania ugody, to postępowanie pojednawcze nie przyniesie efektu w postaci podpisania ugody, a zatem wszczynanie takiego postępowania będzie pozbawione sensu i nieuniknione stanie się wszczęcie procesu. Niewykluczone, że w przypadku niektórych skomplikowanych sporów wszczęcie postępowania pojednawczego może być uzasadnione. W prostych sprawach, np. o zapłatę niewielkiej kwoty pieniężnej, przymusowe stosowanie procedury pojednawczej wydaje się jednak zbędne i może jedynie przedłużyć i utrudnić rozstrzygnięcie sporu oraz narazić strony na dodatkowe koszty.

Odpowiedz:

NIE

Pytanie nr 66

Pakiet nr 27

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego o następującym składzie i parametrach:

- 1 serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)
- 1 serweta na stół Mayo złożona teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) - 1 przylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)
- 1 przylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm)
- 2 przylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm)
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Zestaw wykonany z laminatu 2-warstwowego (polipropylen- polietylen) o gramaturze 55 g/m² + warstwa chłonna o gramaturze 55 g/2 (łącznie 110 g/m²).

Zestaw spełnia wymagania normy EN 13795 dla wysokich parametrów użytkowych obszarów krytycznych wyrobu, gdzie nieprzemakalność serwet podstawowych w strefie krytycznej wynosi > 200 H₂O (wymóg w/w normy to ≥100 H₂O) a wytrzymałość na wypychanie/ rozrywanie w strefie krytycznej wynosi >150 kPa (wymóg w/w normy to ≥40 kPa)

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 67

Pakiet nr 27

Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana o następującym składzie i parametrach:

- 1 serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)
- 1 serweta na stół Mayo złożona teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) - 1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) 320 x 225 cm (pad chłonny 105 x 150 cm)
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm
- 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm

- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Zestaw wykonany z laminatu 2-warstwowego (polipropylen- polietylen) o gramaturze 55 g/m² + warstwa chłonna o gramaturze 55 g/2 (łącznie 110 g/m²).

Zestaw spełnia wymagania normy EN 13795 dla wysokich parametrów użytkowych obszarów krytycznych wyrobu, gdzie nieprzemakalność serwet podstawowych w strefie krytycznej wynosi > 200 H₂O (wymóg w/w normy to ≥100 H₂O) a wytrzymałość na wypychanie/ rozrywanie w strefie krytycznej wynosi >150 kPa (wymóg w/w normy to ≥40 kPa)

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 68

Pakiet nr 27

Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety posiadającej otwór o średnicy 10 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 69

Pakiet nr 27

Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety samoprzylepnej spełniającej pozostałe wymogi

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 70

Dotyczy pakietu 1, poz. 10.

Prosimy o informacje, jakiego typu przetworników używa Zamawiający, jeżeli to możliwe prosimy o podanie producenta oraz numeru katalogowego, lub wydzielenie pozycji 10 do odrębnego pakietu.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 71

Dotyczy pakietu 7, poz. 1-5 .

Prosimy o wydzielenie pozycji od 1 do 5 do odrębnego pakietu celem złożenia oferty na asortyment bezpośrednio od producenta.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 72

Pakiet nr 2, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania zestawu do odsysania pola operacyjnego Yankauer– dren o długości 2100 cm lub 3500 cm z uniwersalną końcówką + kanka Yankauer 20-22CH, z możliwością regulacji siły ssania lub bez, pakowany sterylnie w podwójne opakowanie folia papier.

Odpowiedz:

DOPUSZCZA 35000 cm

Pytanie nr 73

Pakiet nr 2, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zestawów i drenów pakowanych podwójnie: wewnątrz w perforowaną folię dla lepszej ewakuacji tlenu etylenu używanego do sterylizacji oraz zewnątrz w opakowanie foliowo-papierowe?

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 74

Pakiet nr 5, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego zestawu do tracheostomii przezskórnej metodą jednostopniową Ciagli zawierający oddzielnie pakowane, sterylne elementy o następującym składzie:

1/ Zestaw użytkowy z: rozszerzaczem wstępnym o zagiętej końcówce, rozszerzaczem w kształcie rogu ze stoperem, kaniulą punkcyjną, skalpelem, strzykawką Luer-lock, prowadnicą Seldingera z zakończeniem ‘J’, żółtą tulejką przewodnikiem.

2/ Rurka tracheotomijna z mankietem nisko-ciśnieniowym, z ruchomą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia, rurka z przewodnikiem-intubatorem pokrytym hydrofilną powłoką z otworem na prowadnicę Seldingera i stoperem, opaska mocująca na szyję z zapięciem na rzep.

Odpowiedz:

NIE DOPUSZCZA

Pytanie nr 75

Pakiet nr 5, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, sterylnego, gotowego do natychmiastowego użycia zestawu do wykonania konikotomii metodą bezpośredniego wkłucia z potrójnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy lub przedniej ściany przełyku obejmujące : atraumatyczną igłę-introductor z ograniczonym tnącym ostrzem na szerokości 2 mm i rozszerzającym na szerokość 4 mm, z potwierdzonym klikim mechanizmem cofającym ostrze igły po osiągnięciu światła tchawicy oraz usuwalny ogranicznik głębokości wsunięcia kaniuli.

W zestawie: kaniula oddechowa (rurka) do wentylacji z mankietem, z anatomicznie ukształtowaną ramką mocującą, rurka z efektem pamięci, dzięki któremu anatomicznie ukształtowana kaniula (rurka) dopasowuje się do kształtu tchawicy po wysunięciu igły-introductor; rozszerzalna silikonowa przestrzeń martwa, skalpel, strzykawka do identyfikacji światła tchawicy, strzykawka do napełnienia mankieta uszczelniającego, opaska mocująca z zapięciem na rzepy. Rozmiar I.D. 4mm.

Odpowiedz:

NIE DOPUSZCZA

Pytanie nr 76

Pakiet nr 11, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie łącznika karbowanego o dł. 15-20,5cm, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 77

Pakiet nr 11, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego o pojemności 10ml, spełniającego pozostałe wymogi siwz

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 78

Pakiet nr 11, poz. 9

1/ Czy zamawiający dopuści: sterylny cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych oraz uniwersalny, mikrobiologicznie czysty, adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną , z możliwością stosowania przez 7 dni, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, podania leku, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką, kompatybilny z cewnikiem powyżej.

2/ W związku z dostępnością cewników w układzie zamkniętym na dwie oraz trzy doby , prosimy Zamawiającego o przeliczenie kosztu ostatecznego na jedną dobę, co da możliwość porównania oferowanego asortymentu. Ewentualny wybór oferty z cewnikiem w systemie zamkniętym na 48 godzin pomimo pozorów korzystniejszej ceny może narazić Zamawiającego na poniesienie większych kosztów eksploatacji, w porównaniu z możliwością użycia zamkniętego systemu do odsysania o ok. 33% dłuższym okresie użytkowania, a jednocześnie będzie stanowił istotne uchybienie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedz:

NIE DOPUSZCZA

Pytanie nr 79

Pakiet nr 12, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: jednorazowy układ oddechowy, jednorurowy dwuświatłowy z pionową membraną, o śr. 22 mm do respiratora dł. 180 cm, z kolankiem z portem kapno. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H₂O i wydechowy 0,17 H₂O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180 cm. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 50 cm. Jednorazowy, bez DEHP, z niebieskimi elastycznymi złączami.

Odpowiedz:

NIE DOPUSZCZA

Pytanie nr 80

Pakiet nr 12, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: jednorazowy układ oddechowy, jednorurowy dwuświatłowy z pionową membraną, o śr. 22 mm i dł. 180 cm, z kolankiem z portem kapno, do aparatów do znieczulania z dodatkową rurą rozciągalną od 83 do 300 cm i z 2 l workiem bezlateksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H₂O i wydechowy 0,17 H₂O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180 cm. Ruyra wydechowa do podłączenia do apartu rozciągliwa do 50 cm. Jednorazowy, bez DEHP, z niebieskimi elastycznymi złączami.

Odpowiedz:

NIE DOPUSZCZA

Pytanie nr 81

Pakiet nr 14, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do autotransfuzji pooperacyjnej składającego się z:

- 2-ch drenów spiralnych z trokarami 16CH, łącznika Y,
- mieszka z uchwytem na kciuk i zastawką antyzwrotną o poj. 125ml, powodującym początkowy aktywny drenaż 65mmHg, pozwalający na automatyczne przejście na drenaż pasywny bez rozłączania systemu,
- worka na krew o pojemności 700 ml z zastawką antyzwrotną i początkowym filtrem krwi 200µ.
- worka na drenaż przedłużony 700ml, z zastawką antyzwrotną i kranikiem spustowym
- specjalnym aparatem do przetoczeń z filtrem 40µ z aktywną redukcją lipidów, leukocytów oraz białka C3, dostosowany do szybkich przetoczeń, zapewniający najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 82

Pakiet nr 18, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska i czy kaniula ma być o minimalnym przepływie 67 ml/min.

Odpowiedz:

TAK – minimalny przepływ 67 ml/min

Pytanie nr 83

Pakiet 19, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod numeryczny umieszczony na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wewnętrzna część konektora ma być karbowana, co zapobiega zsuwaniu się konektora cewnika z końcówki ssaka?

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy otwory boczne w cewniku mają być naprzeciwległe?

Odpowiedz:

TAK

Pytanie nr 84

Pakiet nr 27, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu serwet uniwersalnych w składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm

- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepne na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna
- 1 x serweta górna 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Nieprzemakalność serwet w strefie krytycznej – 200cmH₂O przy jednoczesnej wytrzymałości na wypychanie/rozrywanie w strefie krytycznej minimum 197 kPa. Materiał podstawowy obłożenia składa się z minimum 2 warstw: włókniny polipropylenowej i folii PE o łącznej gramaturze 58g/m². Zestaw spełnia wymagania wysokie wg. normy PN EN 13795 1 -3.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 85

Pakiet nr 27, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji kończyn o składzie:

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm
 - 1 x serweta na stolik Mayo min. 77 x 142 cm
 - 1 x stokineta 36,5x72 cm 2-warstwowa
 - 1 x taśma przylepna, 9 x 50 cm
 - 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
 - 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm,
- Zestaw spełnia wymagania wysokie wg. normy PN EN 13795 1 -3, przy czym wytrzymałość na wypychanie/rozrywanie w strefie krytycznej minimum 197 kPa. Materiał podstawowy obłożenia składa się z minimum 2 warstw: włókniny polipropylenowej i folii PE o łącznej gramaturze 58g/m².

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 86

Pakiet nr 27, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwetki z otworem 5x8cm, w pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ.

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 87

Pakiet nr 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie zamiast kart technicznych dla gotowych wyrobów po procesie sterylizacji kart technicznych produktu oraz kart technicznych materiałów wystawionych przez producenta gotowych wyrobów po procesie sterylizacji.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 88

Pakiet nr 36

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy czepek ma posiadać strukturę dwuwarstwową z wyraźnie oddzielną w celu równomiernego rozprowadzania roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej.

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 89

Pakietu 29, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie elektrody nożowej o długości roboczej 1,6 (wymagana długość robocza 1,9). Elektrody spełniają wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Tak nieznaczne różnice w żaden sposób nie wpłyną na jakość użytkową produktu oraz pracę zespołu operacyjnego. Oferowany produkt jest najwyższej jakości od włoskiego producenta. Pozytywna odpowiedź na pytanie poszerzy grono oferentów i korzystnie wpłynie na sytuację ekonomiczną Szpitala.

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 90

Pakietu 29, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie elektrody nożowej przedłużonej powlekanej silikonem o długości 15,3cm (silikon na długości 14,7cm). Elektrody spełniają wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Tak nieznaczne różnice w żaden sposób nie wpłyną na jakość użytkową produktu oraz pracę zespołu operacyjnego. Oferowany produkt jest najwyższej jakości od włoskiego producenta. Pozytywna odpowiedź na pytanie poszerzy grono oferentów i korzystnie wpłynie na sytuację ekonomiczną Szpitala.

Odpowiedz:

DOPUSZCZA

Pytanie nr 91

Dotyczy Pakietu 29, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody kulki od włoskiego producenta, którą oferujemy w rozmiarach: (wymagana \varnothing 3mm oraz długość 10cm)

- \varnothing 4 mm, długość 7cm
- \varnothing 2 mm, długość 5,4cm
- \varnothing 4 mm, długość 15,6cm

Różnica w zarówno w średnicy, jak i długości jest nieznaczna, co nie wpłynie w żaden sposób na wartość produktu i pracę Zespołu operacyjnego.

Odpowiedz:

DOPUSZCZA \varnothing 4 mm, długość 7cm

Pytanie nr 92

Pakietu 31, poz. 2

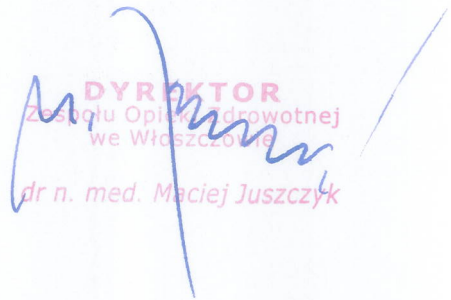
Ze względu na możliwość zaferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, Z PEWNA KORZYŚCIĄ EKONOMICZNĄ DLA SZPITALA, KTÓRY DOKONA WYBORU SPOŚRÓD WIĘKSZEJ ILOŚCI OFERT, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia

zwrotnego, kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego i posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania, których całkowita powierzchnia czynna wynosi 107cm², a wymiar całkowity wynosi 16,4cm x 11,7cm (wymagane 18x11,5cm); Opakowanie posiada nadruk, bez naklejek.

Tak nieznaczna różnica wymiaru nie wpłynie na wartość użytkową ani sposób pracy Zespołu operacyjnego. NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU I JEST UNIWERSALNA, TZN, ŻE MOŻE BYĆ APLIKOWANA U PACJENTÓW DOROSŁYCH JAK I U DZIECI (DODATKOWA ZAleta). Pragniemy podkreślić, że elektrody te są zakupywane w Europie w ilości ponad 4 MILIONÓW sztuk rocznie i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych wykonujących zabiegi na aparatach wymienionych przez Państwa w wymogach SIWZ, także w kilkudziesięciu szpitalach na terenie Polski.

Odpowiedz:

DOPUSZCZA wymiary, natomiast etykiety do wklejenia są wymagane


DIREKTOR
Zespołu Opieki zdrowotnej
we Włoszczowie
dr n. med. Maciej Juszczyk

ST. INSPEKTOR
Dział Obsługi Adm.-Tech.
24p
Regina Wolska